

### Zamawiający

Nazwa \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Data pomiaru \_\_\_\_\_  
Osoba zamawiająca \_\_\_\_\_  
Numer kontaktowy \_\_\_\_\_

### Pacjent

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

	JOBST	Elvarex					Elvarex Soft			
<b>1 Liczba sztuk</b>		1	2	3	3F	4	4S	1	2	3
<b>Klasa ucisku (CCL)</b>										
lewa noga										
prawa noga										
pas biodrowy										

2 Podstawowe modele	
<b>JOBST Elvarex &amp; Elvarex Soft</b>	
<input type="radio"/> AD <input type="radio"/> AT <input type="radio"/> CT capri ^ <input type="radio"/> AG <input type="radio"/> B'T legginsy ^ <input type="radio"/> ET bermudy >10 cm <input type="radio"/> AG-T <input type="radio"/> BT legginsy ^ <input type="radio"/> FT szorty=10 cm	
<b>JOBST Elvarex</b>	
<input type="radio"/> AB^ <input type="radio"/> AB1^ <input type="radio"/> AF^ <input type="radio"/> AG-HT	
segmenty nogawic <input type="radio"/> B'G <input type="radio"/> BG <input type="radio"/> CG	

3 Pas biodrowy	
<b>skośne zakończenie*</b>	<input type="radio"/>
proste zakończenie	<input type="radio"/>
Strefa Komfortu TOP <input type="radio"/>	
wersja męska bez rozporka	<input type="radio"/>
wersja męska z rozporkiem	<input type="radio"/>
zamek błyskawiczny	<input type="radio"/> z przodu <input type="radio"/> z lewej strony <input type="radio"/> z prawej strony
<small>(możliwy przy wykończeniu: klasycznym dzianinowym, regulowaną gumką w talii, miękkim pasie biodrowym z rzepem)</small>	
klasyczne dzianinowe	<input type="radio"/>
regulowana gumka w talii	<input type="radio"/>
miękki pas biodrowy	<input type="radio"/>
miękki pas biodrowy z rzepem	<input type="radio"/>
Sensitive	<input type="radio"/>
silikonowe kropki	<input type="radio"/>


### Uwagi:

	JOBST	Elvarex	Elvarex Soft
<b>4 Dodatki</b>			
<b>skośne zakończenie*</b>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/> AD
proste zakończenie	<input type="radio"/>		<input type="radio"/> AG
<b>Strefa Komfortu TOP</b>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/> AG
Strefa Komfortu KOLANO™	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> CCL 2-4S	
zamek błyskawiczny	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> wewn. <input type="radio"/> zewn. <input type="radio"/> B-D <input type="radio"/> E-G	

5 Nogawice	
<b>JOBST Elvarex &amp; Elvarex Soft</b>	
SoftFit	<input type="radio"/> AD CCL 1-3
silikon (kropki)	<input type="radio"/> 5,0 cm góra <input type="radio"/> AD 2,5 cm góra <input type="radio"/> 1/2 wewnątrz ^ <input type="radio"/> 3/4 wewnątrz ^
	dodatkowe silikonowy w skosie na zewnątrz <input type="radio"/> 15 cm <input type="radio"/> 20 cm <input type="radio"/> 25 cm
<b>mikro-kropki</b>	<input type="radio"/> 5,0 cm góra (AD, AG, segmenty) (dodatkowe silikonowe mikro-kropki wewnątrz zgodnie z informacjami w aktualnych broszurach)

6 Stopy	
Pięta-T	<input type="radio"/> CCL 2-3F <input type="radio"/>
wyściółka w zgięciu Y	<input type="radio"/>
peloty	<input type="radio"/> zewn. <input type="radio"/> wewn.
<b>JOBST Elvarex &amp; Elvarex Soft</b>	
skośna stopa*	<input type="radio"/> & <input type="radio"/> odkryte palce <input type="radio"/>
prosta stopa	<input type="radio"/> & <input type="radio"/> zakryte palce <input type="radio"/>

6 Kolor	
<b>JOBST Elvarex*</b>	
<input type="radio"/> beige <input type="radio"/> bronze <input type="radio"/> cranberry <input type="radio"/> navy <input type="radio"/> black <input type="radio"/> caramel <input type="radio"/> grey	
<input type="radio"/> henna <input type="radio"/> graphit <input type="radio"/> aubergine <input type="radio"/> denim <input type="radio"/> stone	
<b>JOBST Elvarex Soft*</b>	
<input type="radio"/> beige <input type="radio"/> cherry <input type="radio"/> macchiato <input type="radio"/> sunflower yellow <input type="radio"/> black <input type="radio"/> cranberry <input type="radio"/> navy <input type="radio"/> bronze <input type="radio"/> grey <input type="radio"/> pine green	

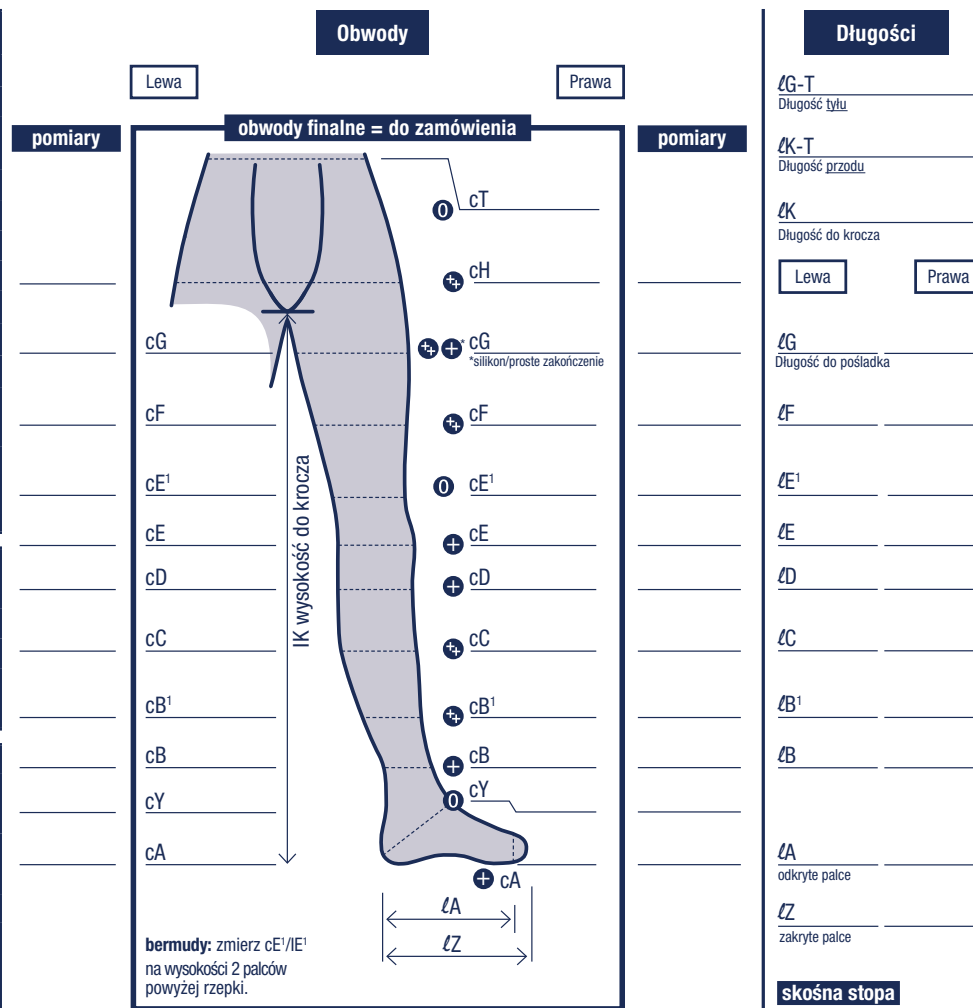

**Stosuj różne napięcia miarki:**  
dla zaprojektowania odzieży płaskodzianej z optymalnym efektem terapeutycznym pomiary obwodów należy dokonywać z różnym napięciem miarki.

pomiar bez zaciskania miarki  
 lekkie zaciskanie miarki  
 silne zaciskanie miarki