

### Zamawiający

Nazwa \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Data pomiaru \_\_\_\_\_  
Osoba zamawiająca \_\_\_\_\_  
Numer kontaktowy \_\_\_\_\_

### Pacjent

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

1	JOBST	Elvarex			Elvarex Plus <sup>▲</sup>		Elvarex Soft Seamless		
		Klasa ucisku (CCL)	1	2	3	1	2	1	2
L. sztuć	lewa stopa								
	prawa stopa								

2	Opcje	Elvarex	Elvarex Plus <sup>▲</sup>	Elvarex Soft Seamless
4 palce		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> standard
	5 palców	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	


3	Wykończenia	Elvarex	Elvarex Plus <sup>▲</sup>	Elvarex Soft Seamless
skos otworu małego palca		<input type="radio"/> 0,5 cm	<input type="radio"/> 0,5 cm	
		<input type="radio"/> 1,0 cm	<input type="radio"/> 1,0 cm	
		<input type="radio"/> 1,5 cm	<input type="radio"/> 1,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 1,5 cm standard

4	Kolor	JOBST Elvarex <sup>*</sup>	JOBST Elvarex Plus <sup>*</sup>	JOBST Elvarex Soft Seamless <sup>*</sup>
Kolor		<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> cranberry	<input type="radio"/> red
		<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> grey	
		<input type="radio"/> bronze	<input type="radio"/> hazelnut	
		<input type="radio"/> caramel	<input type="radio"/> navy	
		<input type="radio"/> navy		
		<input type="radio"/> cherry	<input type="radio"/> pine green	
		<input type="radio"/> cranberry	<input type="radio"/> sunflower yellow	

▲ JOBST Elvarex Plus wymagane jest podanie obwodów wszystkich 5 palców

W przypadku stóp, wszystkie pomiary obwodów proszę wykonywać bez zaciskania miarki.

⓪ pomiar bez zaciskania miarki

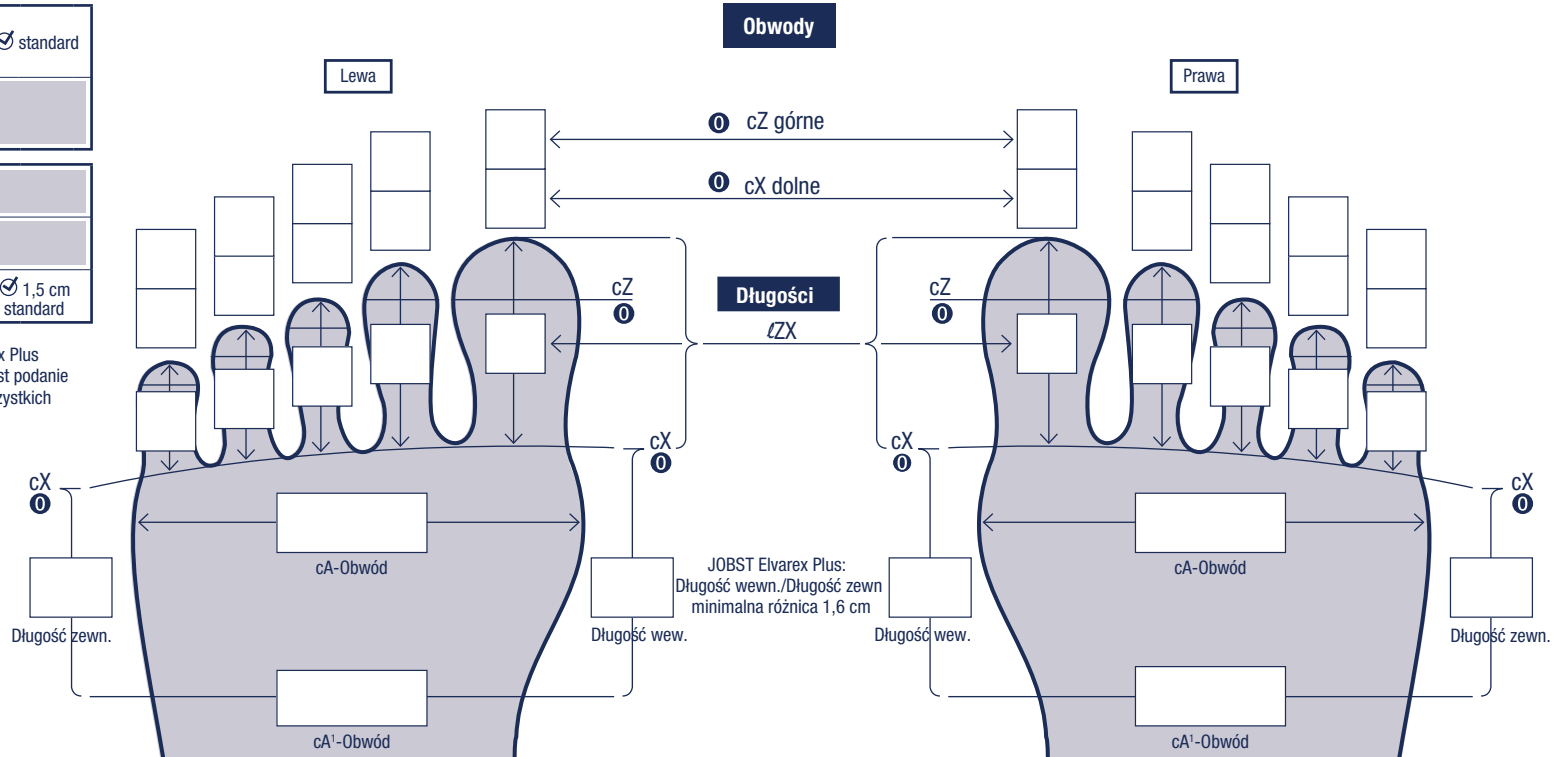

### Uwagi